

<b>Nom</b> WANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FUSUO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/04/1970	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 55 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC EPC3
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 449	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,6 °C  
 Pression atmosphérique : 101,3 kPa  
 Humidité : 64 %

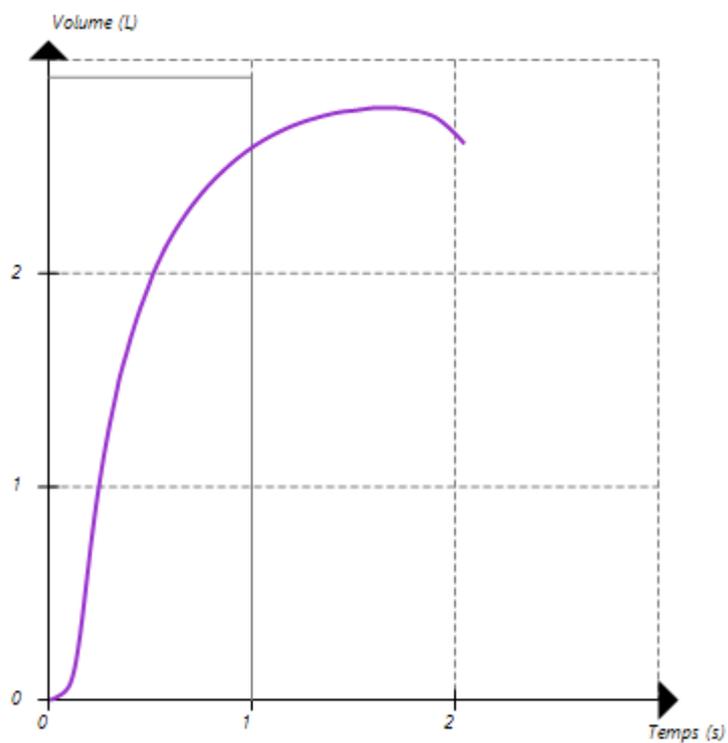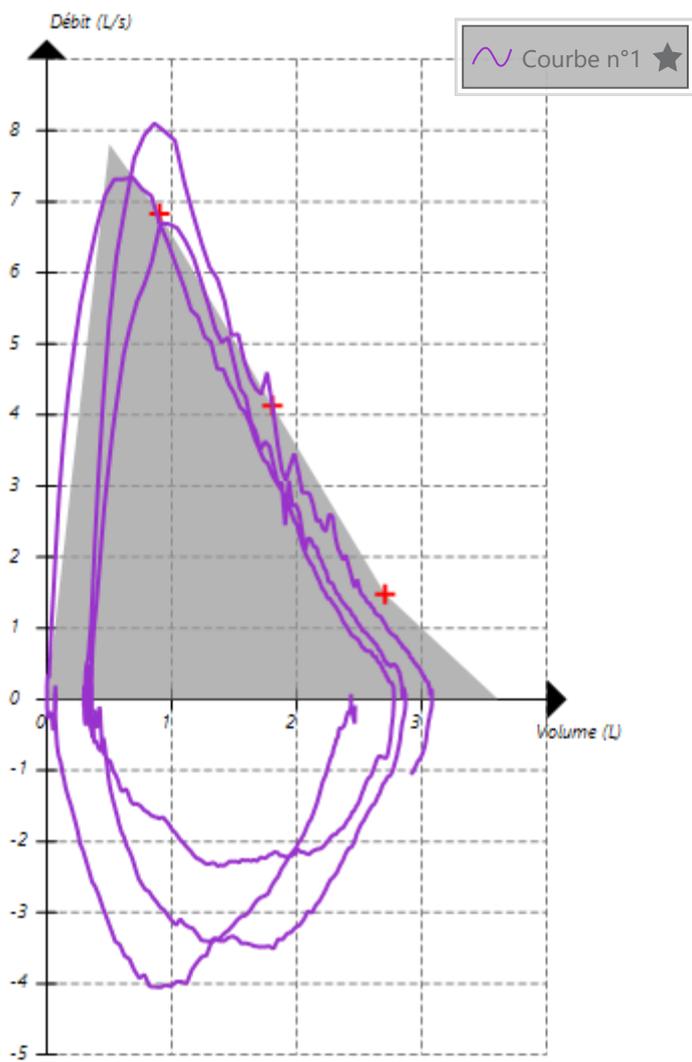

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,78 L	3,61 L	77,01 %
VEMS	2,65 L	2,92 L	90,75 %
DÉP	8,15 L/s	7,81 L/s	104,35 %
VEMS/CVF	95,32 %	77,36 %	123,22 %
Durée d'expiration	1,60 s	-	
DEMM	3,95 L/s	3,50 L/s	112,86 %
DEMM/CVF	1,42 s <sup>-1</sup>	0,97 s <sup>-1</sup>	146,39 %
DE75	7,97 L/s	6,83 L/s	116,69 %
DE50	4,36 L/s	4,13 L/s	105,57 %
DE25	1,96 L/s	1,48 L/s	132,43 %