

<b>Nom</b> YANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YONGQING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/07/1974	<b>Profession</b> SUPERVISEUR
<b>Age</b> 51 Ans	<b>Entreprise</b> CHEC EPC3
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 447	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 84 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 30,2 °C  
 Pression atmosphérique : 101,3 kPa  
 Humidité : 61 %

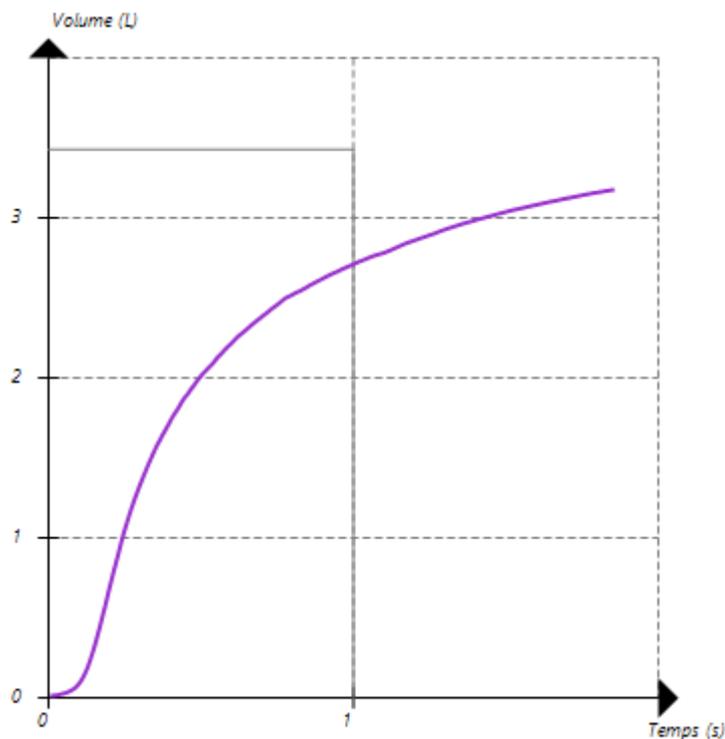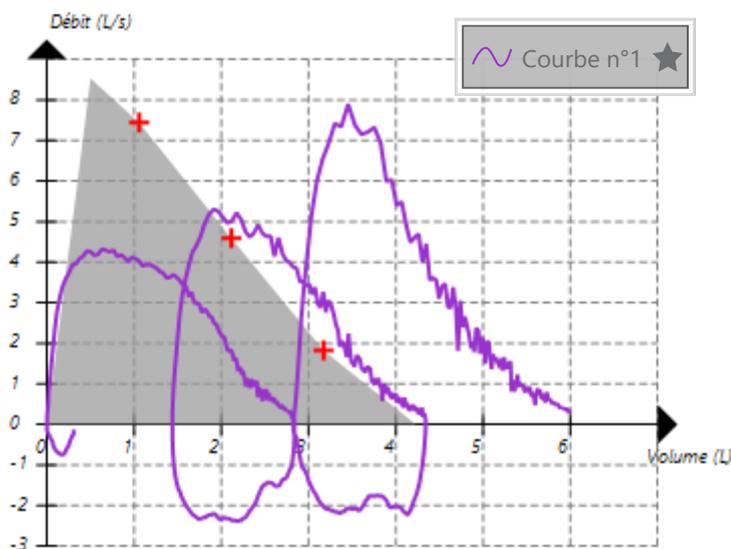

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,17 L	4,23 L	74,94 %
VEMS	2,78 L	3,43 L	81,05 %
DÉP	8,00 L/s	8,53 L/s	93,79 %
VEMS/CVF	87,70 %	78,08 %	112,32 %
Durée d'expiration	1,94 s	-	
DEMM	3,26 L/s	3,85 L/s	84,68 %
DEMM/CVF	1,03 s <sup>-1</sup>	0,91 s <sup>-1</sup>	113,19 %
DE75	7,25 L/s	7,44 L/s	97,45 %
DE50	3,38 L/s	4,59 L/s	73,64 %
DE25	1,75 L/s	1,82 L/s	96,15 %