

<b>Nom HE</b> <b>Prénom RENBO</b> <b>Né le</b> 15/01/1983 <b>Age</b> 42 Ans <b>Genre</b> Masculin <b>ID</b> 442 <b>Taille</b> 170 cm <b>Poids</b> 61 kg <b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal <b>Opérateur</b> admin admin	<b>Adresse</b> <b>Exposition</b> <b>Profession</b> SOUDEUR <b>Entreprise</b> CHEC EPC3 <b>Service</b> <b>Fumeur</b> Fumeur <b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong <b>Prescripteur:</b> <b>Smoking Pack Years</b> : 0
---	---



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,8 °C

Pression atmosphérique : 101,3 kPa

Humidité : 65 %

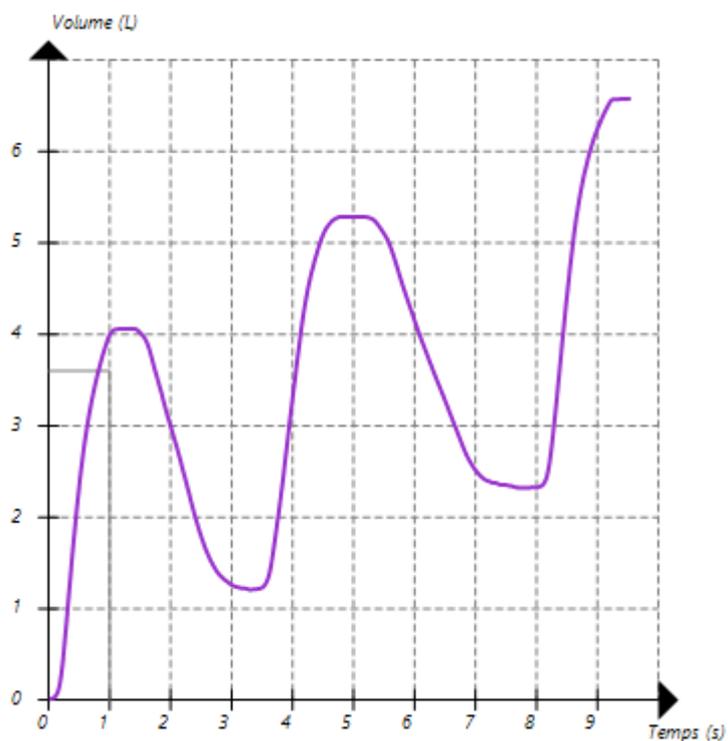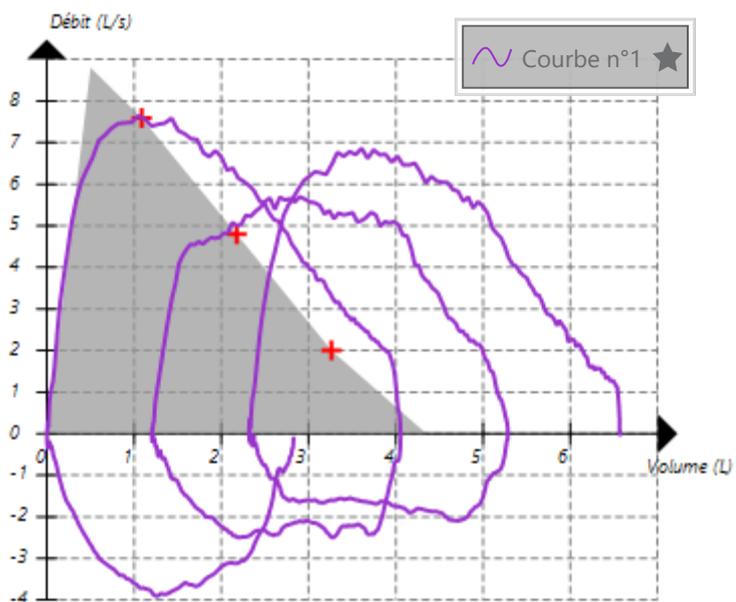

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,06 L	4,35 L	93,33 %
VEMS	4,05 L	3,60 L	112,50 %
DÉP	7,76 L/s	8,80 L/s	88,18 %
VEMS/CVF	99,75 %	79,69 %	125,17 %
Durée d'expiration	1,39 s	-	
DEMM	6,14 L/s	4,20 L/s	146,19 %
DEMM/CVF	1,51 s <sup>-1</sup>	0,97 s <sup>-1</sup>	155,67 %
DE75	7,49 L/s	7,59 L/s	98,68 %
DE50	6,58 L/s	4,80 L/s	137,08 %
DE25	3,94 L/s	2,00 L/s	197,00 %