


<b>Nom WAN</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom YING</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 03/02/1969</b>	<b>Profession MACON</b>
<b>Age 56 Ans</b>	<b>Entreprise CHEC EPC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 25</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 158 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 48 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecce/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,6 °C  
 Numéro de série : 253562      Pression atmosphérique : 101,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026      Humidité : 68 %

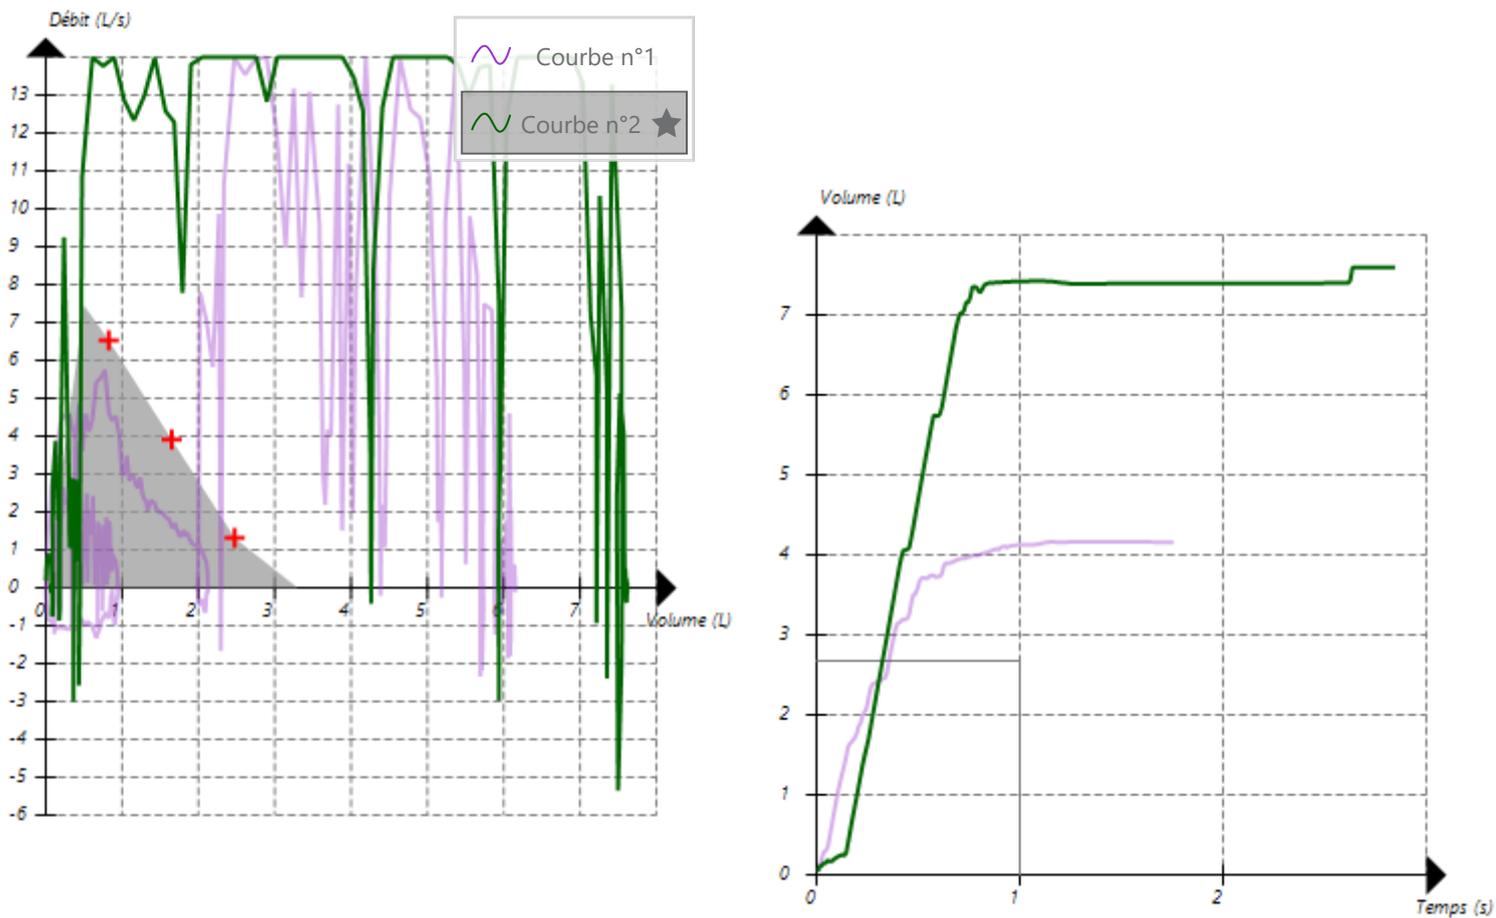

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,17 L	7,43 L	3,30 L	225,15 %
VEMS	4,13 L	7,42 L	2,68 L	276,87 %
DÉP	14,00 L/s	14,00 L/s	7,46 L/s	187,67 %
VEMS/ CVF	99,04 %	99,87 %	77,19 %	129,38 %
Durée d'expiration	1,36 s	1,06 s	-	
DEMM	7,23 L/s	12,55 L/s	3,36 L/s	373,51 %
DEMM/ CVF	1,73 s-1	1,69 s-1	1,02 s-1	165,69 %
DE75	8,49 L/s	14,00 L/s	6,53 L/s	214,40 %
DE50	13,83 L/s	14,00 L/s	3,91 L/s	358,06 %
DE25	12,46 L/s	14,00 L/s	1,32 L/s	1060,61 %