



<b>Nom NIU</b> <b>Prénom FUHAI</b> <b>Né le</b> 27/06/1980 <b>Age</b> 45 Ans <b>Genre</b> Masculin <b>ID</b> 441 <b>Taille</b> 171 cm <b>Poids</b> 70 kg <b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal <b>Opérateur</b> admin admin	<b>Adresse</b> <b>Exposition</b> <b>Profession</b> CONDUCTEUR GRILL <b>Entreprise</b> CHEC EPC3 <b>Service</b> <b>Fumeur</b> Non fumeur <b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong <b>Prescripteur:</b> <b>Smoking Pack Years</b> : 0
--	--



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024  
 Température ambiante : 29,1 °C  
 Pression atmosphérique : 101,2 kPa  
 Humidité : 67 %

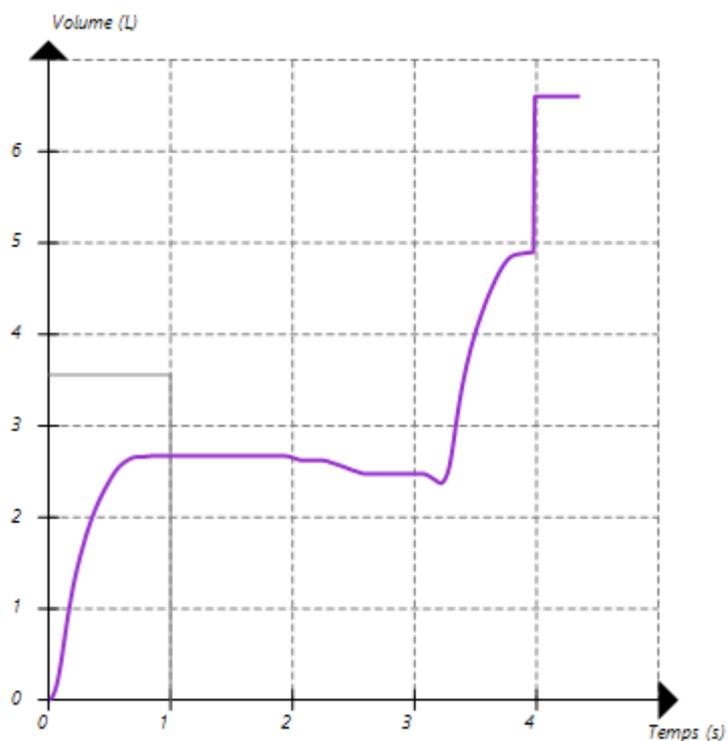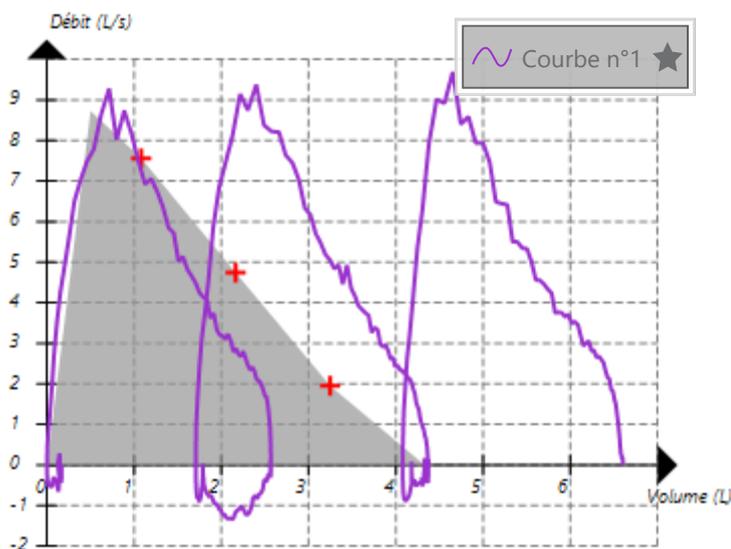

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,67 L	4,33 L	61,66 %
VEMS	2,67 L	3,56 L	75,00 %
DÉP	9,98 L/s	8,73 L/s	114,32 %
VEMS/CVF	100,00 %	79,16 %	126,33 %
Durée d'expiration	1,36 s	-	
DEMM	5,83 L/s	4,09 L/s	142,54 %
DEMM/CVF	2,18 s <sup>-1</sup>	0,94 s <sup>-1</sup>	231,91 %
DE75	9,98 L/s	7,56 L/s	132,01 %
DE50	5,88 L/s	4,74 L/s	124,05 %
DE25	3,18 L/s	1,95 L/s	163,08 %