

<b>Nom LI</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom DEQUAN</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 22/04/1971</b>	<b>Profession FERRAILLEUR</b>
<b>Age 54 Ans</b>	<b>Entreprise CHEC EPC3</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 432</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 164 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 65 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecce/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 26,4 °C  
 Pression atmosphérique : 101,5 kPa  
 Humidité : 73 %

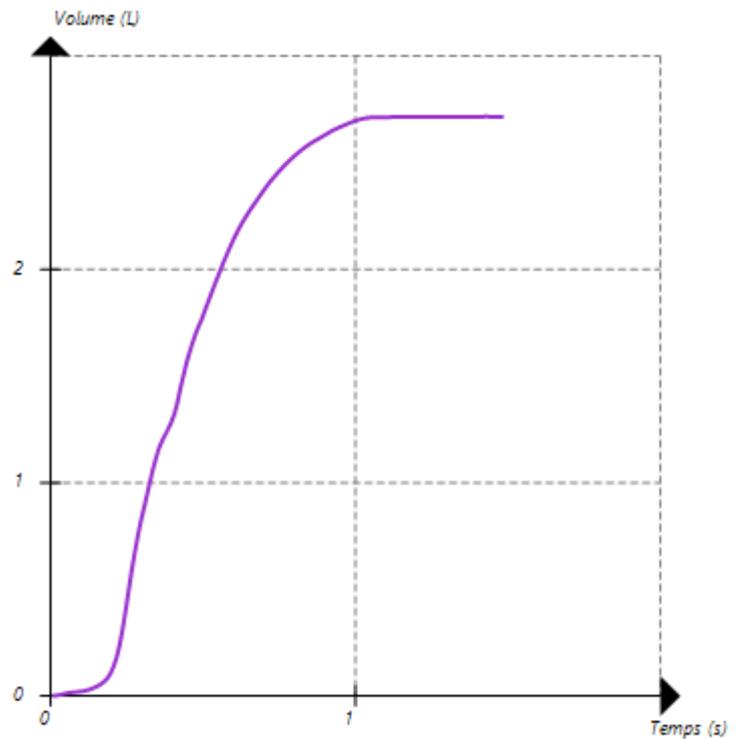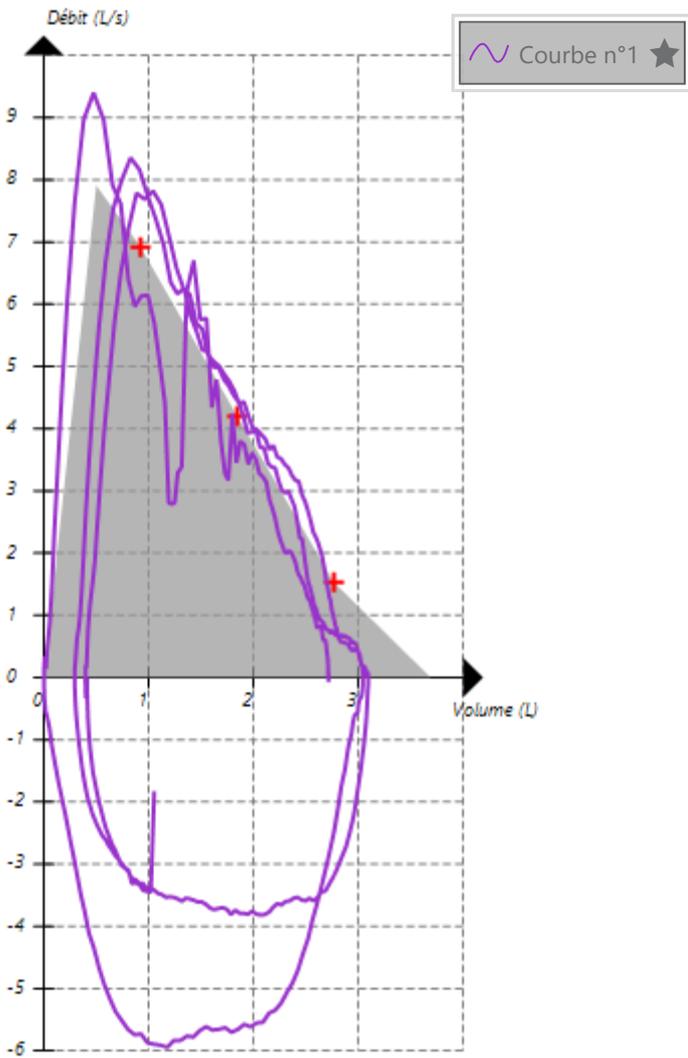

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,72 L	3,69 L	73,71 %
VEMS	2,72 L	3,00 L	90,67 %
DÉP	9,45 L/s	7,91 L/s	119,47 %
VEMS/CVF	100,00 %	77,54 %	128,97 %
Durée d'expiration	1,46 s	-	
DEMM	4,65 L/s	3,57 L/s	130,25 %
DEMM/CVF	1,71 s <sup>-1</sup>	0,97 s <sup>-1</sup>	176,29 %
DE75	7,91 L/s	6,92 L/s	114,31 %
DE50	6,32 L/s	4,20 L/s	150,48 %
DE25	3,30 L/s	1,53 L/s	215,69 %