


MED VIE


Date du test: 29/07/2024 11:32:19
Durée: 5mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SANGARE LAYE
Date de naissance	05/03/1993
Age	31
Société	COVEC
ID	24072911304261862

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

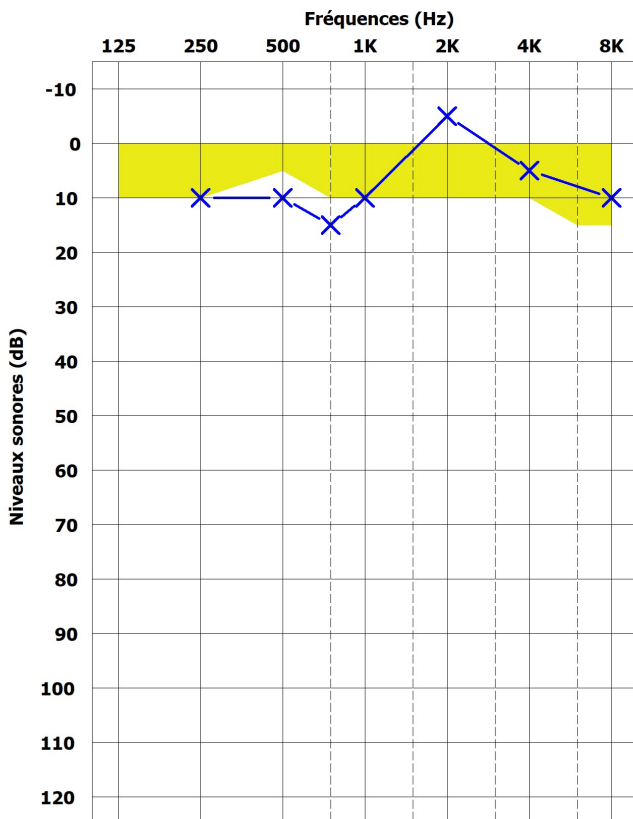

Oreille Gauche

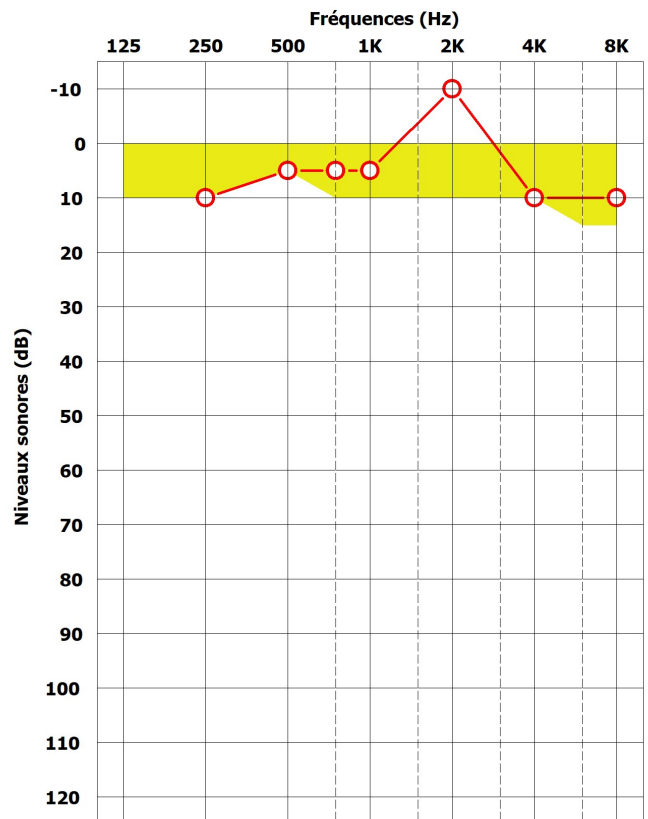

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	10		-5		5		10
CA Droit		10	5	5	5		-10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes