


MEDVIE


Date du test: 30/07/2024 12:53:24

Durée: 4mn 36s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

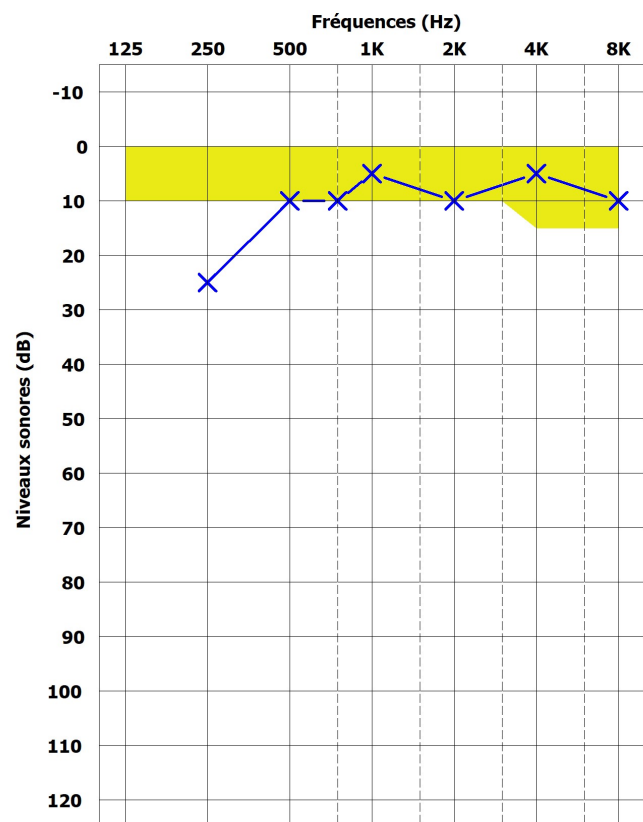

Oreille Gauche

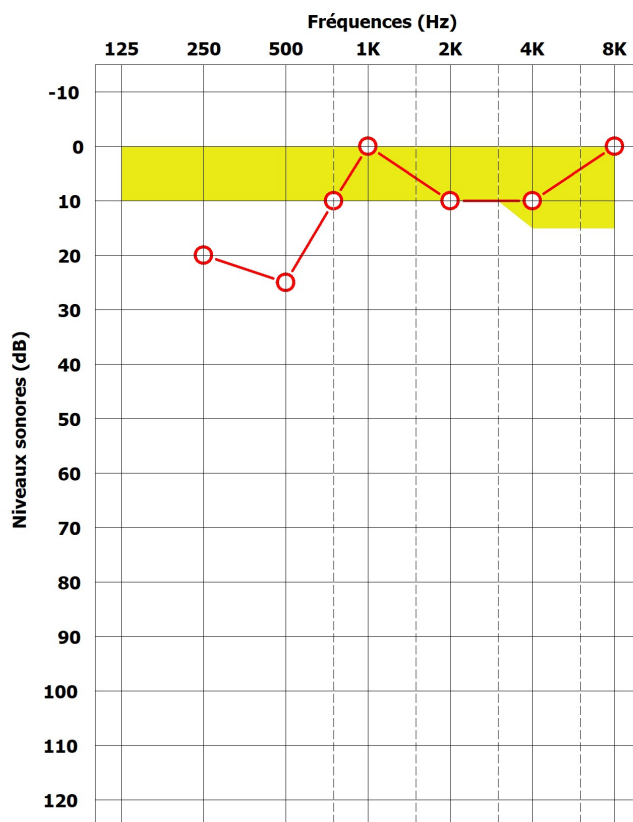

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	10	5		10		5		10
CA Droit		20	25	10	0		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	BAMBA Kemo
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	COVEC
ID	24073012513683185

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021