


MED VIE


Date du test: 29/07/2024 11:07:35
Durée: 3mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE BANGALY
Date de naissance	15/06/1976
Age	48
Société	COVEC
ID	24072911053693194

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

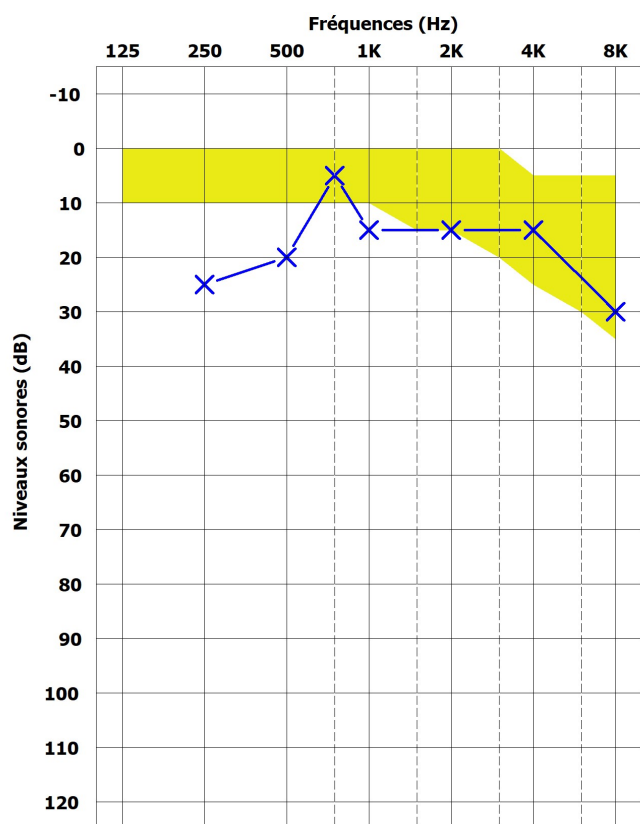

Oreille Gauche

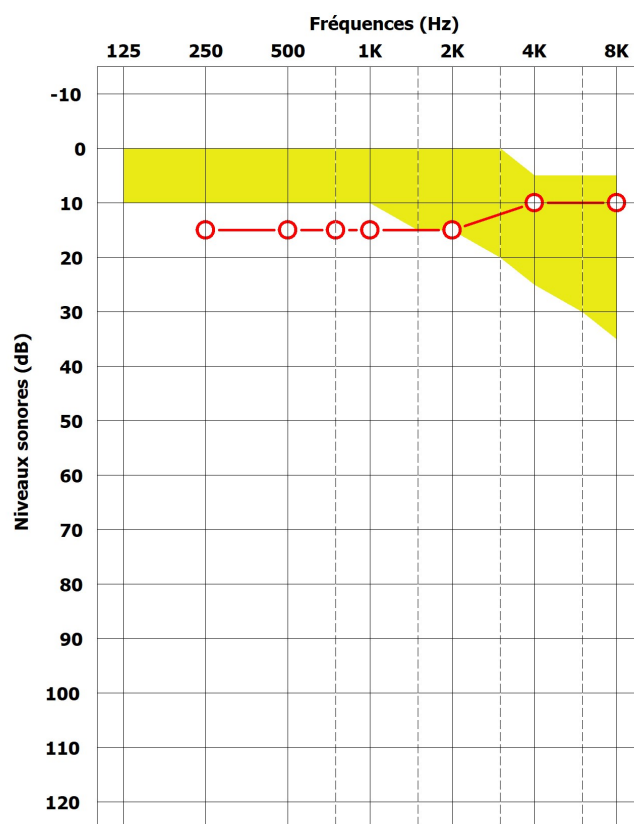

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	5	15		15		15		30
CA Droit		15	15	15	15		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes