

MED VIE


Date du test: 29/07/2024 10:58:08

Durée: 6mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KEITA KABINET
Date de naissance	05/02/1980
Age	44
Société	COVEC
ID	24072910561004158

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

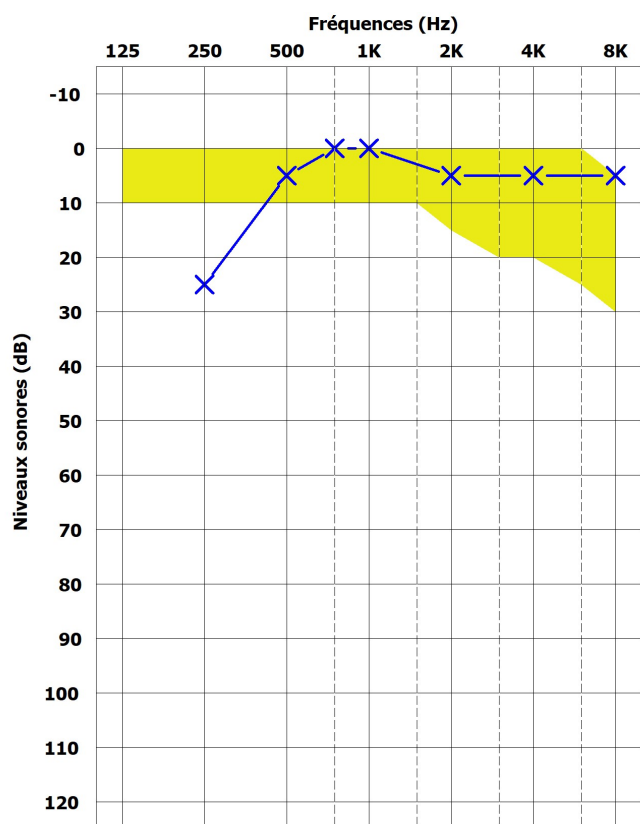

Oreille Gauche

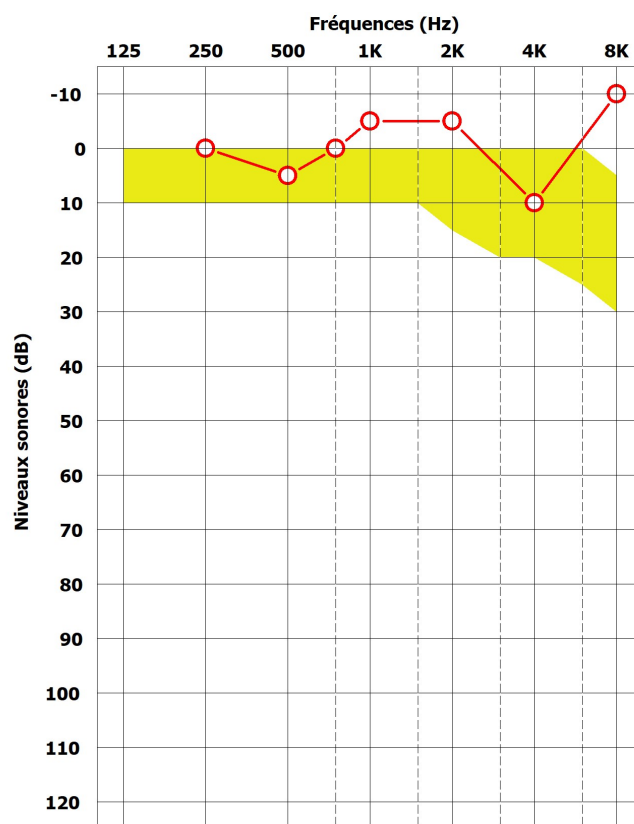

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	0	0		5		5		5
CA Droit		0	5	0	-5		-5		10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes