


MED VIE


Date du test: 29/07/2024 10:27:39
Durée: 9mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	COVEC
ID	24072910243303434

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

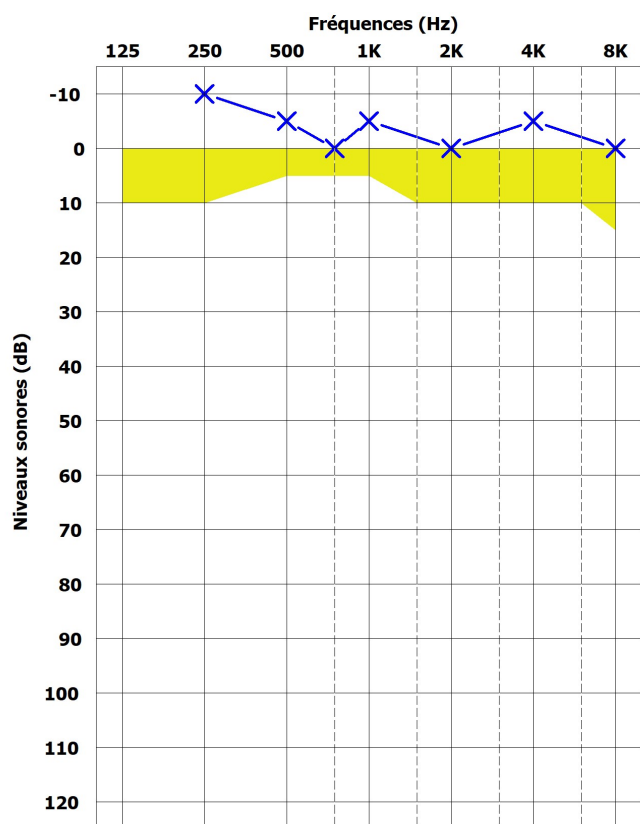

Oreille Gauche

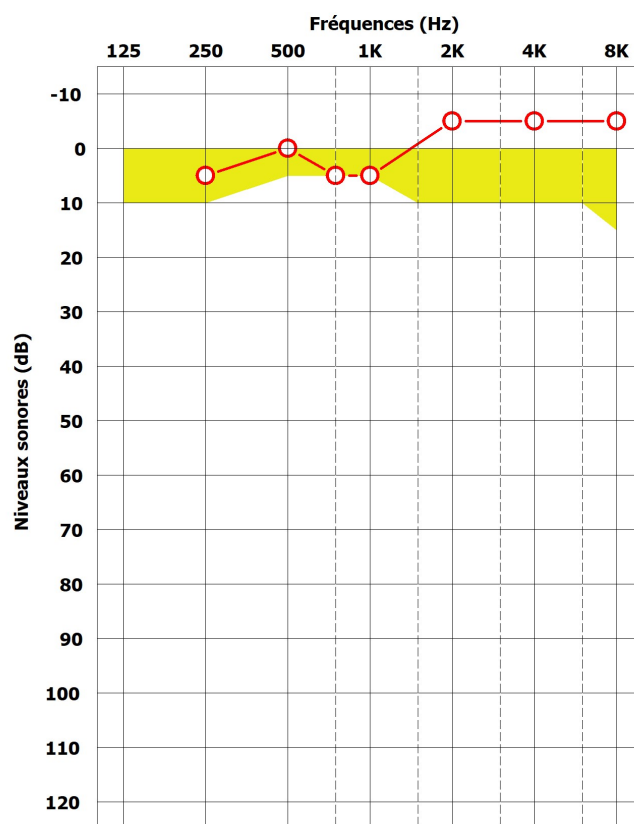

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-5	0	-5		0		-5		0
CA Droit		5	0	5	5		-5		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-3,8 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes