


MED VIE


Date du test: 29/07/2024 12:59:20
Durée: 6mn 19s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO Mamady	
Date de naissance	24/01/1990
Age	34
Société	BECEIP
ID	24072912562912651

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

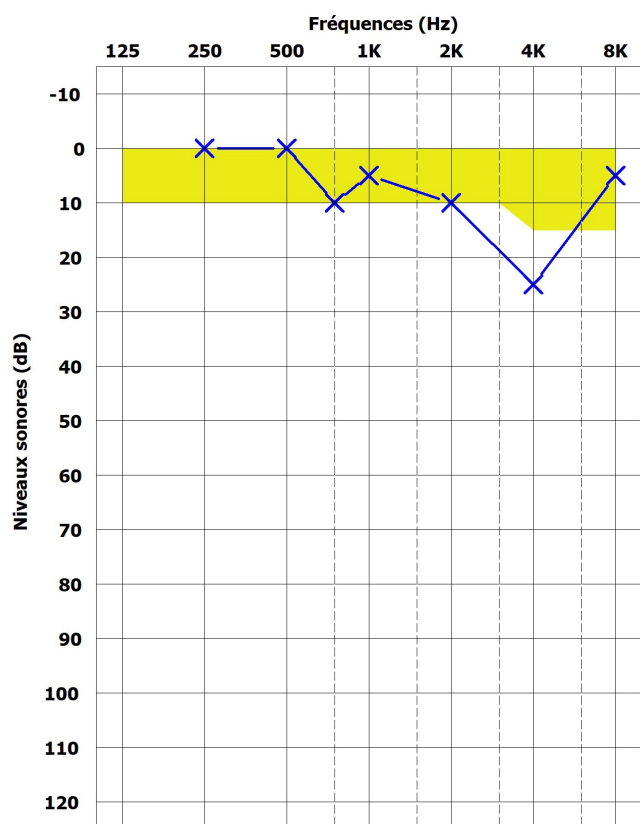

Oreille Gauche

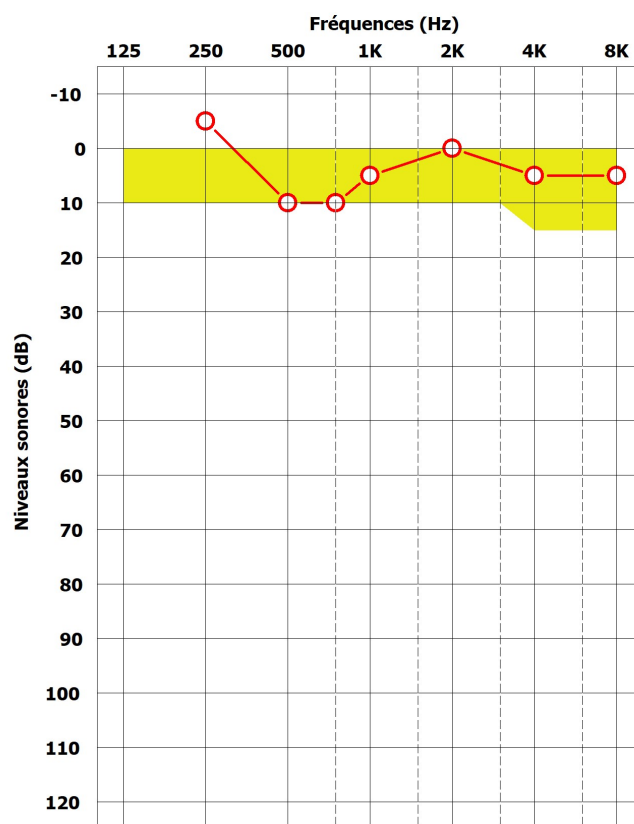

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	10	5		10		25		5
CA Droit		-5	10	10	5		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes