


Données Patient	CONDE MAMOUDOU
Date de naissance	07/05/1991
Age	33
Société	BCEIP
ID	24072911490137852


MED VIE

Date du test: 29/07/2024 11:50:53
 Durée: 6mn 24s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

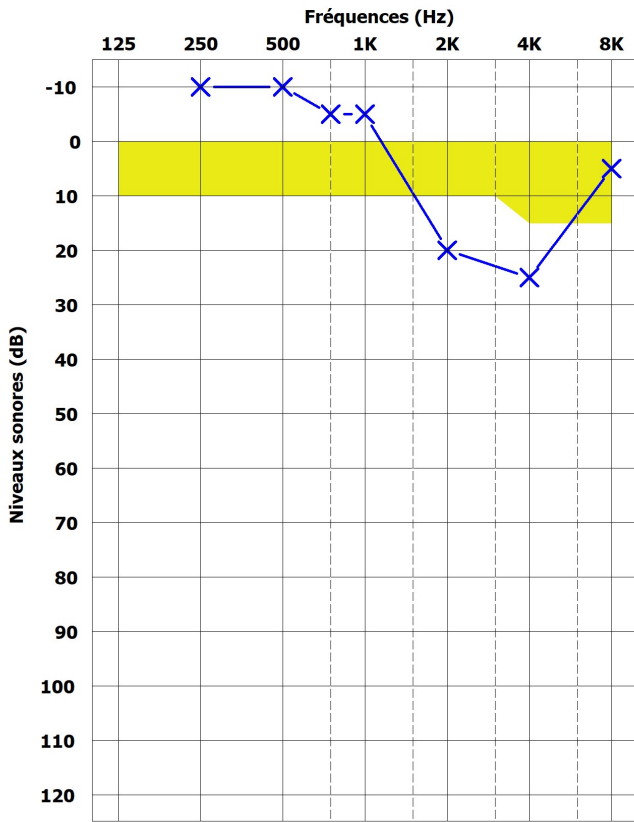

Oreille Gauche

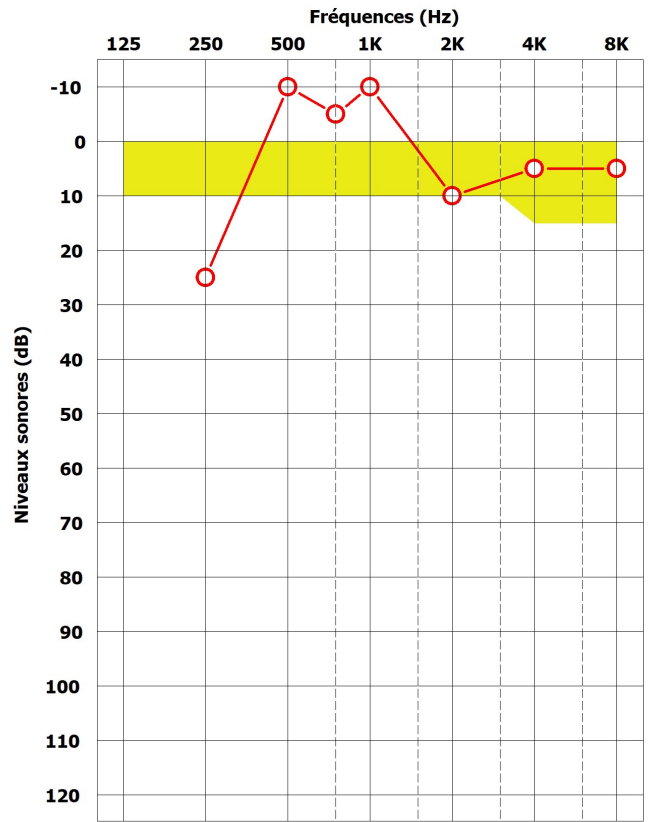

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	-5	-5		20		25		5
CA Droit		25	-10	-5	-10		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes