


MED VIE


Date du test: 29/07/2024 12:13:53
Durée: 7mn 06s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ALSENY	
Date de naissance	10/09/1989
Age	34
Société	BCEIP
ID	24072912122701555

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

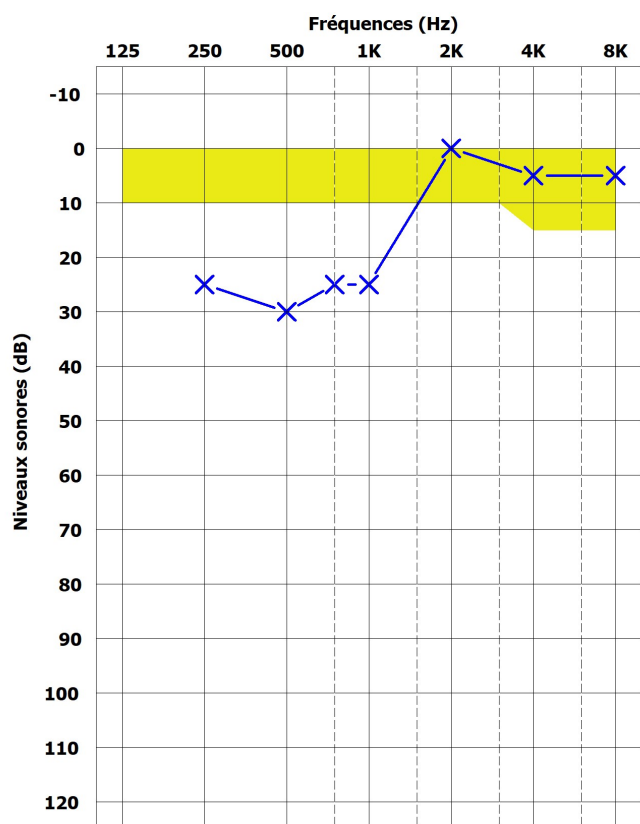

Oreille Gauche

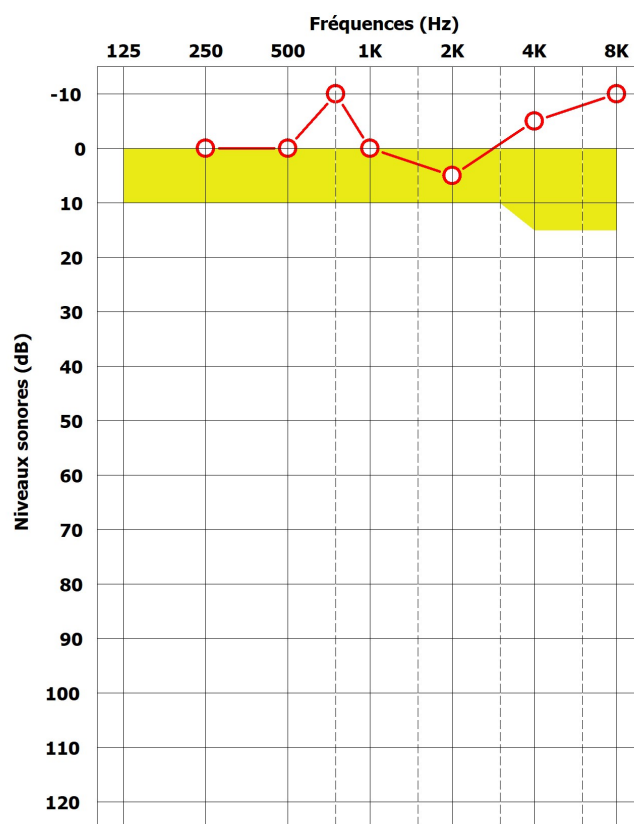

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	25		0		5		5
CA Droit		0	0	-10	0		5		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes