

MED VIE


Date du test: 27/07/2024 10:18:50

Durée: 5mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO MAMADOU
Date de naissance	02/02/1993
Age	31
Société	GPC
ID	24072710084190544

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

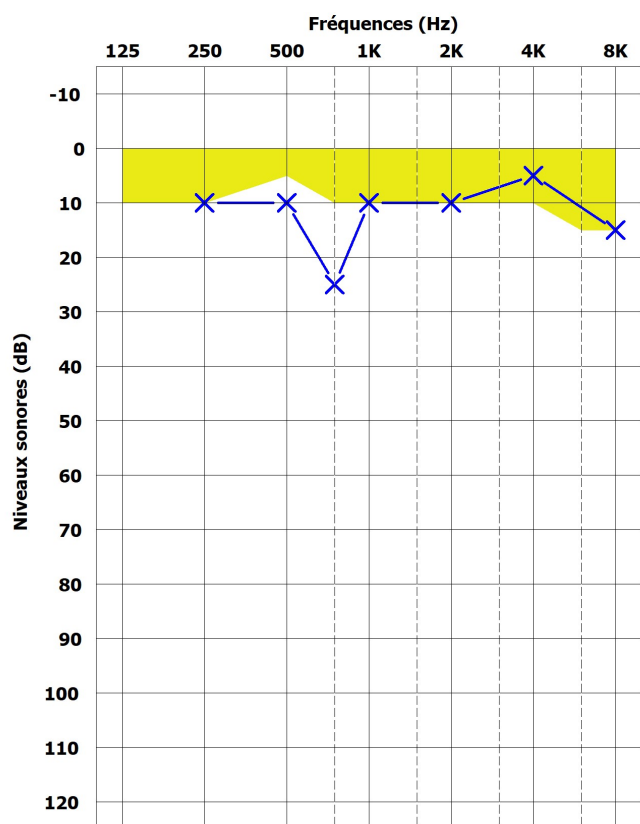

Oreille Gauche

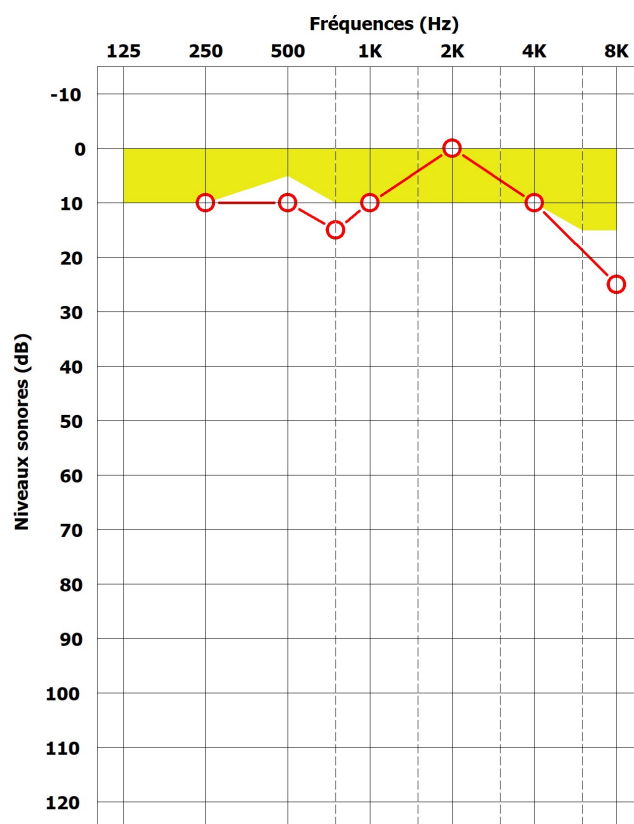

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	25	10		10		5		15
CA Droit		10	10	15	10		0		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes