

MEDVIE


Date du test: 29/07/2024 15:09:08

Durée: 3mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA M'MAH	
Date de naissance	03/11/1975
Age	48
Société	MMF MULTI SERVICE
ID	24072915021931213

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

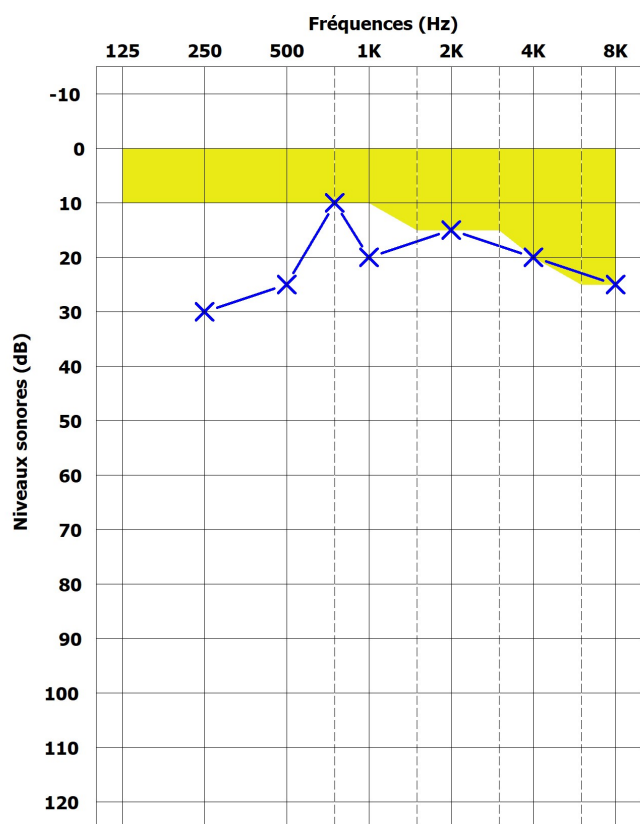

Oreille Gauche

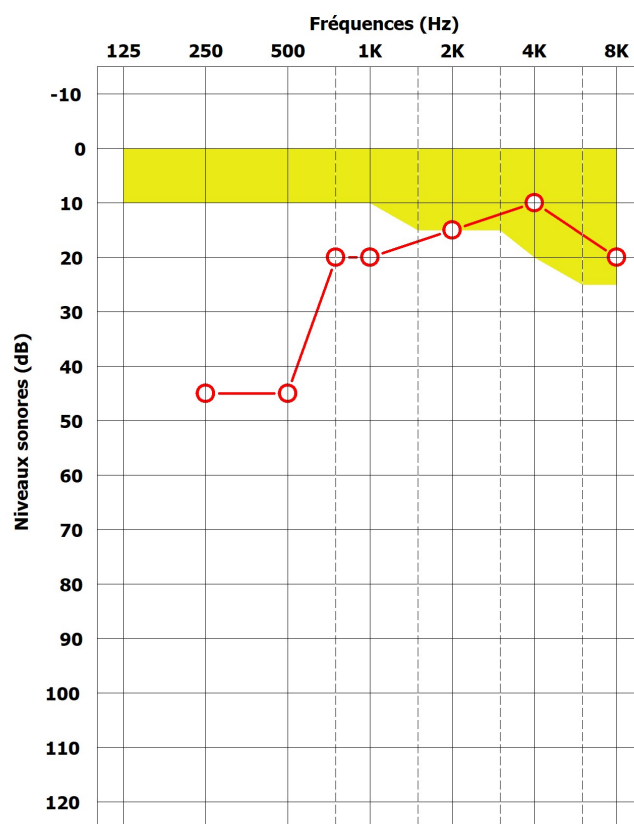

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	10	20		15		20		25
CA Droit		45	45	20	20		15		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes