

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ARAFAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> OPERATEURR CHARGEUR
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 557	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 27,1 °C  
 Pression atmosphérique : 101 kPa  
 Humidité : 60 %

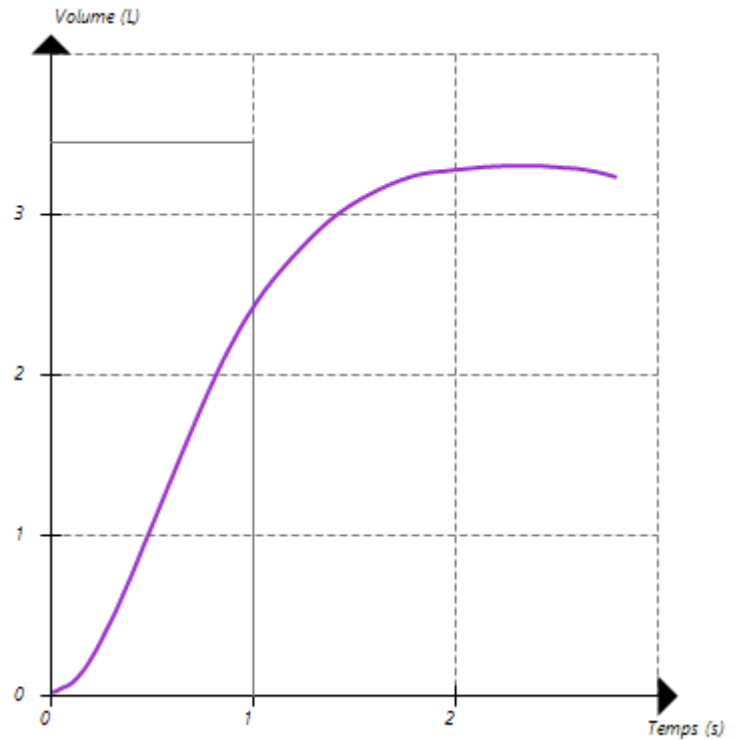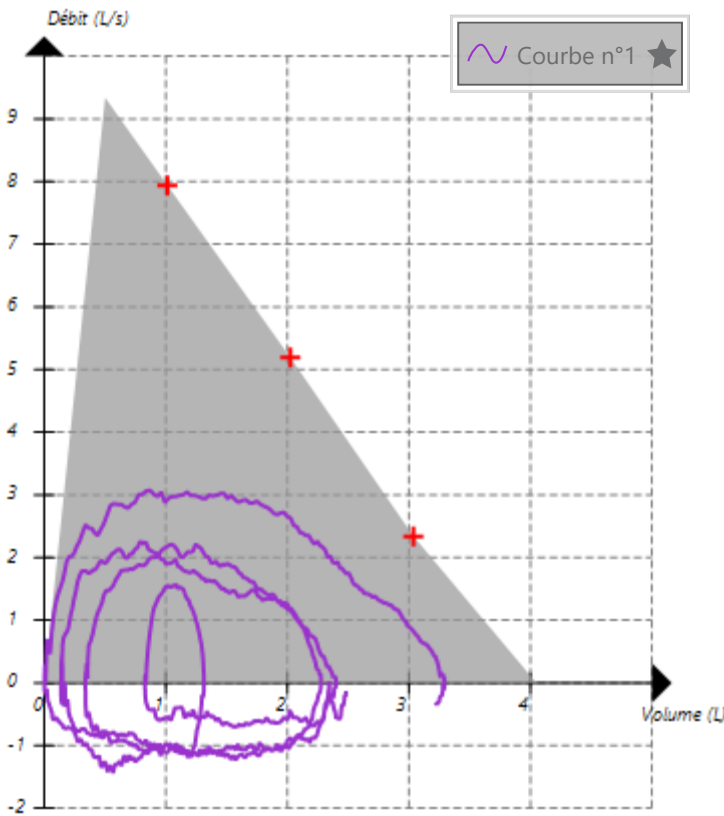

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,29 L	4,05 L	81,23 %
VEMS	2,67 L	3,45 L	77,39 %
DÉP	3,14 L/s	9,34 L/s	33,62 %
VEMS/ CVF	81,16 %	82,20 %	98,73 %
Durée d'expiration	2,38 s	-	
DEMM	2,72 L/s	4,78 L/s	56,90 %
DEMM/ CVF	0,83 s <sup>-1</sup>	1,03 s <sup>-1</sup>	80,58 %
DE75	3,05 L/s	7,94 L/s	38,41 %
DE50	2,88 L/s	5,19 L/s	55,49 %
DE25	1,76 L/s	2,34 L/s	75,21 %