


MEDVIE


Date du test: 16/08/2025 13:44:57

Durée: 3mn 34s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

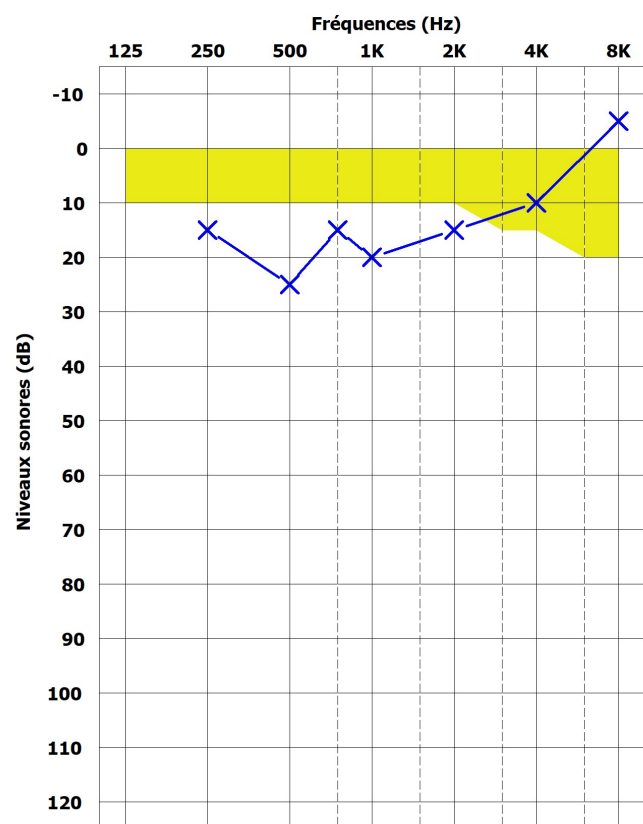

Oreille Gauche

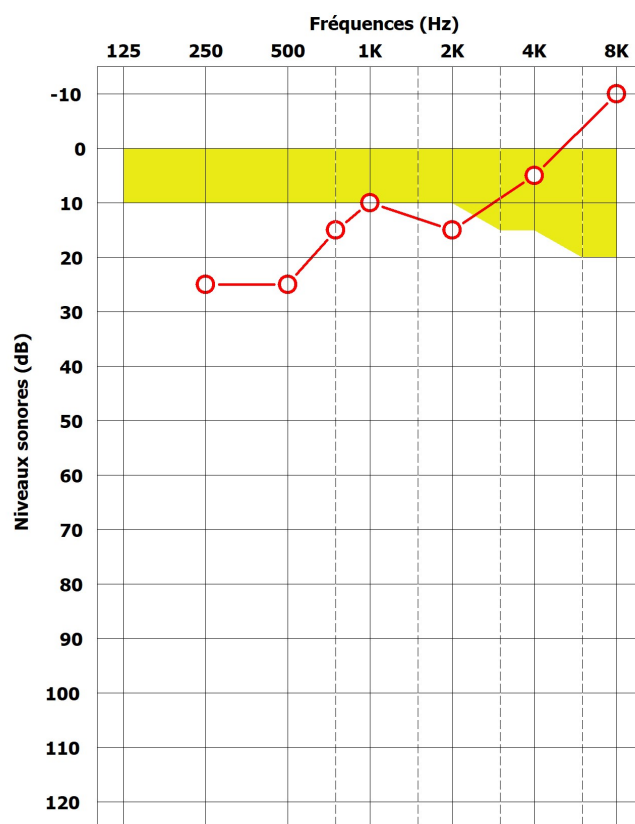

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	15	20		15		10		-5
CA Droit		25	25	15	10		15		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	ZHANG JINGYAN
Date de naissance	11/05/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25081613413415594

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021