

MEDVIE

Date du test: 16/08/2025 13:01:44

Durée: 4mn 24s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

PEI FUGUA

Date de naissance

15/11/1973

Age

51

Société

CR18

ID

25081612583682962

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

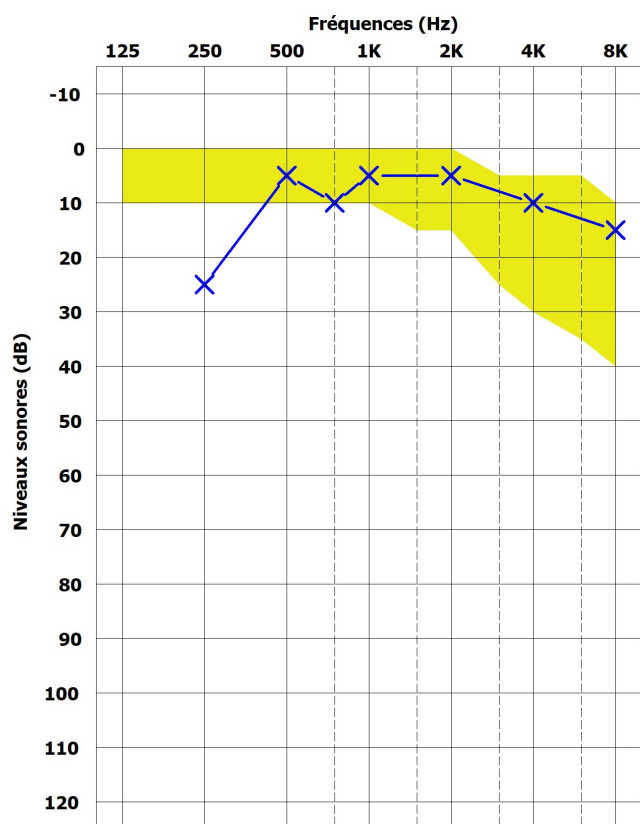

Oreille Gauche

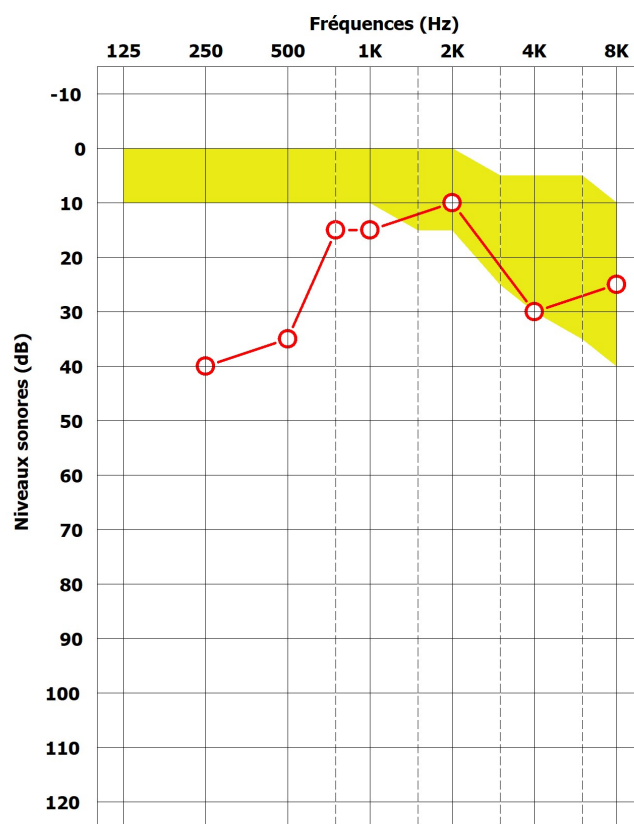

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	10	5		5		10		15
CA Droit		40	35	15	15		10		30		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes